


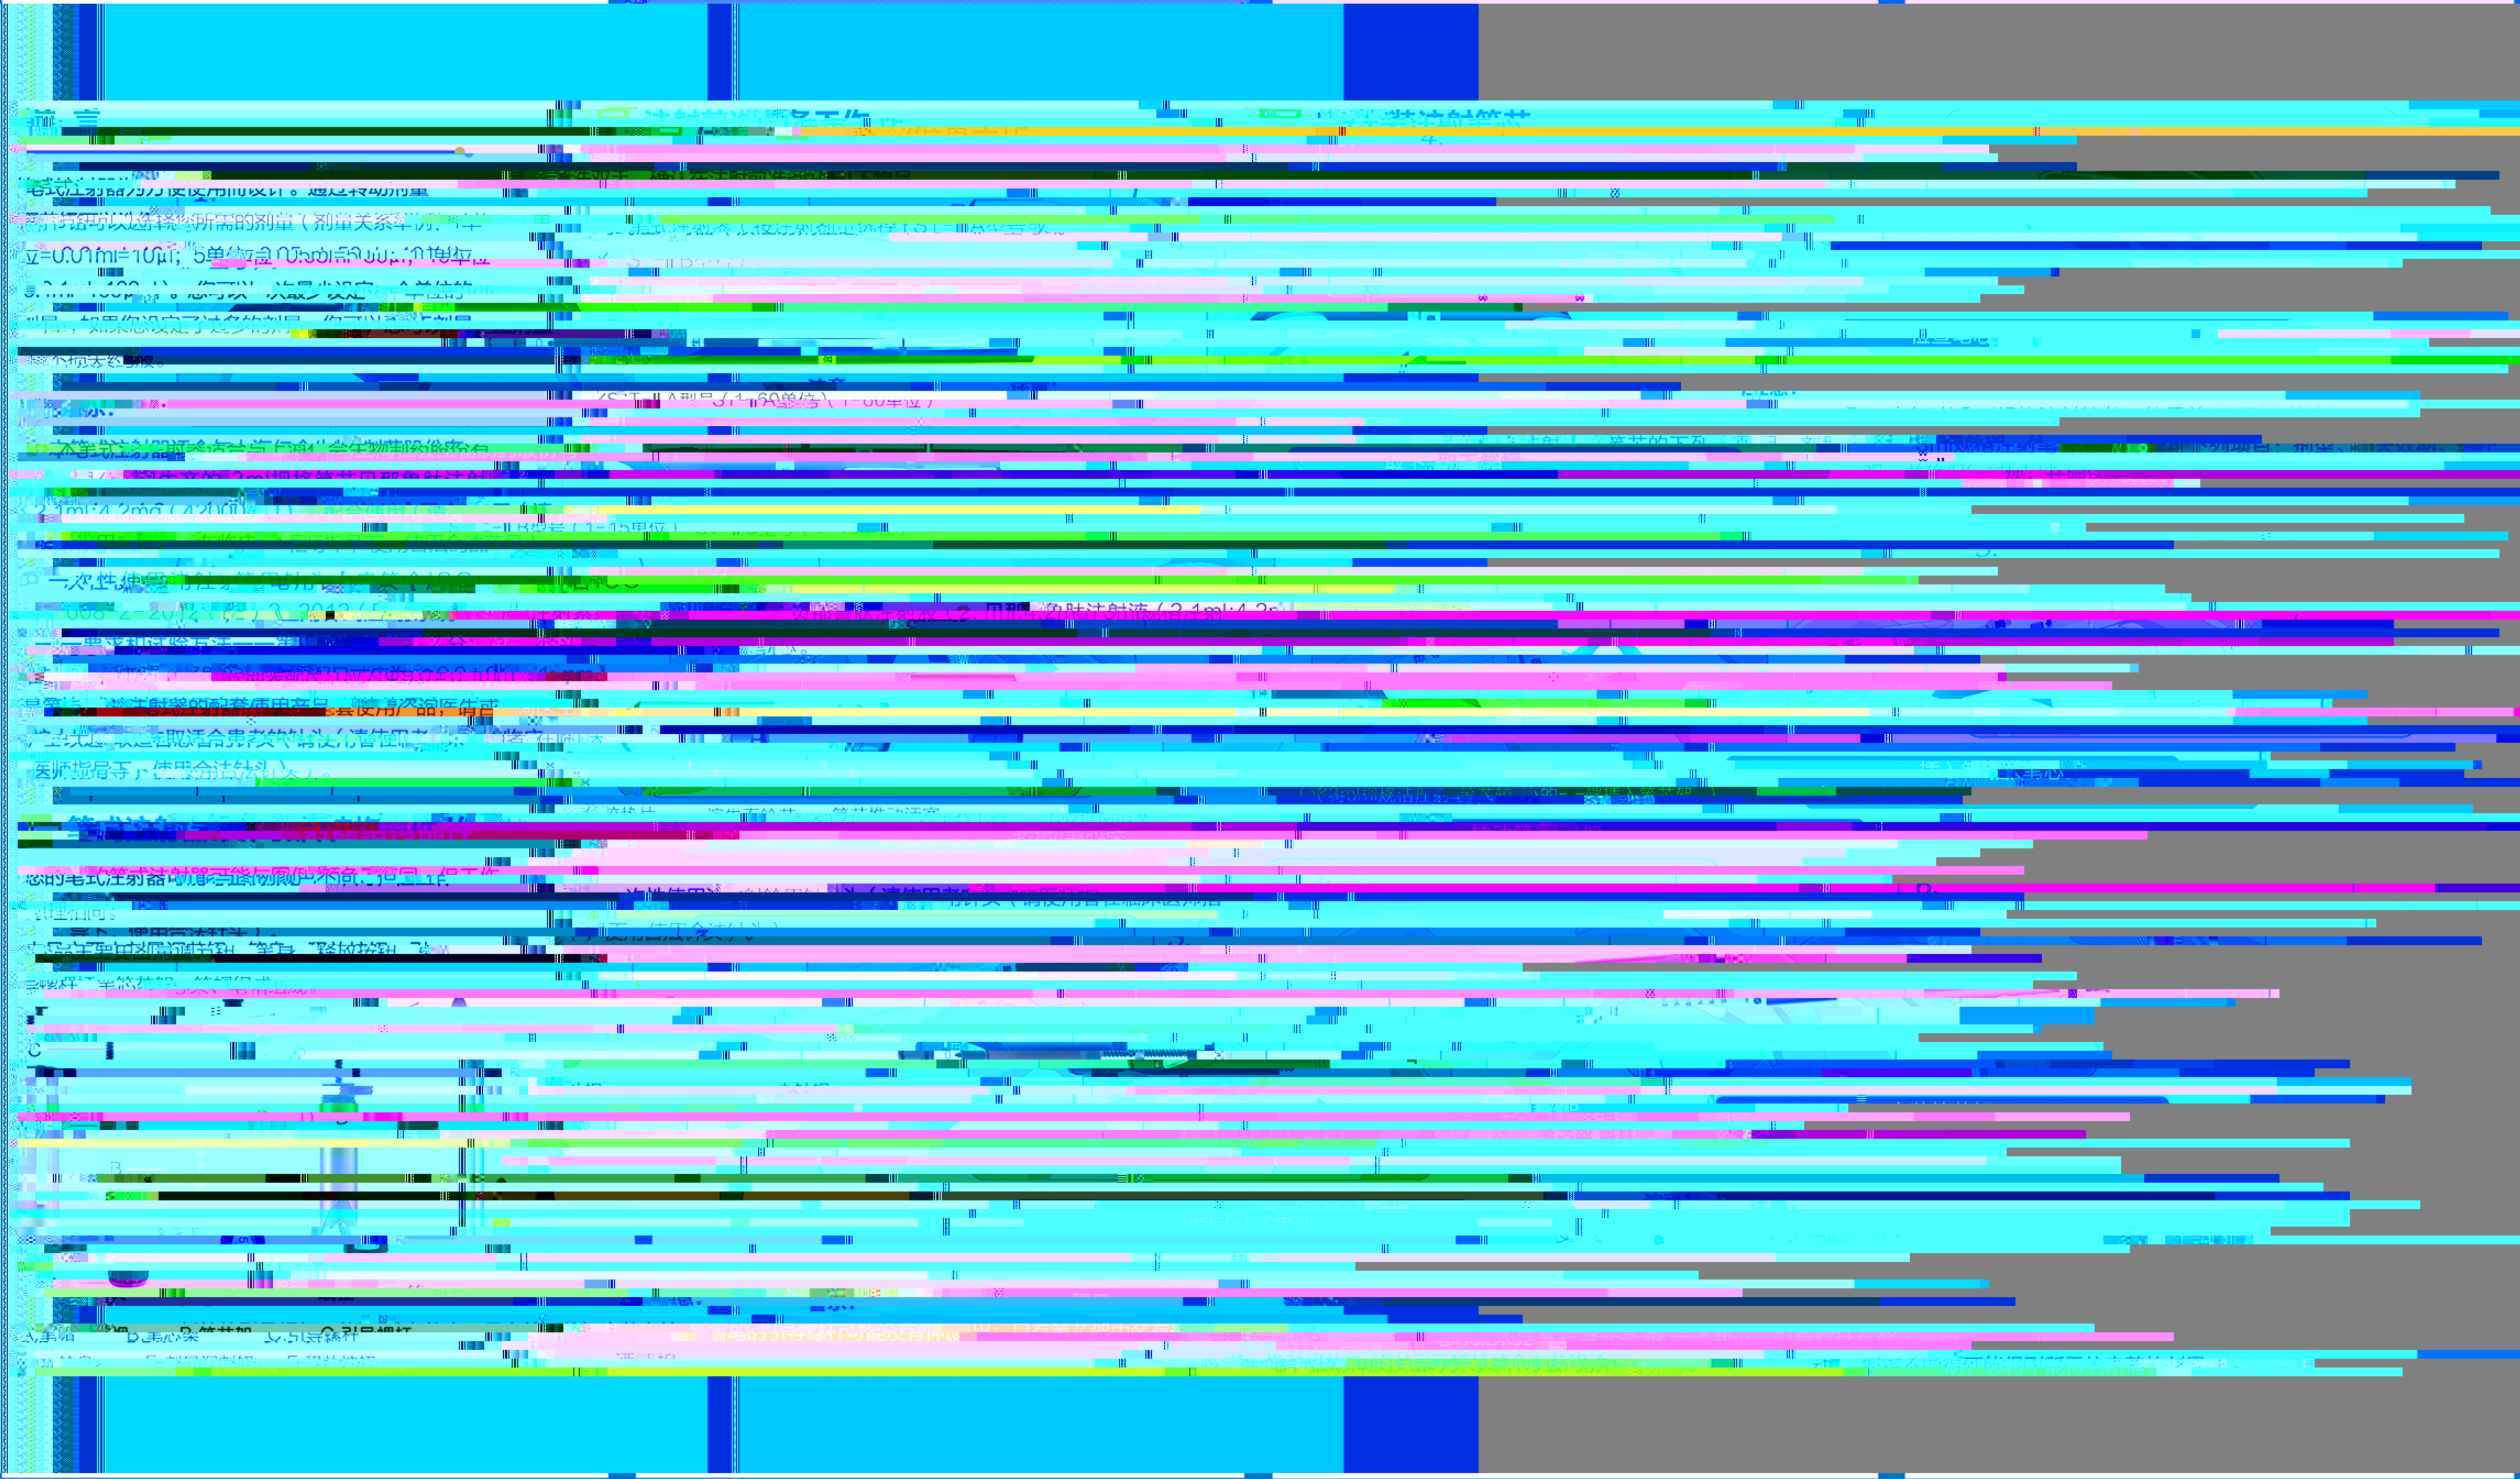

### 六 注射结束 End of Injection

1. 取下针头

(取下针头外针套和内针套，并妥善丢弃针套，以备取下针头时使用。)

2. 取下针头

(取下针头外针套和内针套，并妥善丢弃针套，以备取下针头时使用。)

3. 盖上笔帽

注意：在使用的过程中，如果发现针头有破损，例如断裂、弯曲、漏液、堵塞等，请立即停止使用，并更换新的针头。

1. 为什么引导螺杆不向前移动？

只有正确安装电池后，引导螺杆才能向前移动。并

2. 为什么注射器不能向前移动？

检查电池是否正确安装。如果电池安装不正确，注射器将无法向前移动。然后小心地使笔架与笔身成一条直线，旋转注射器筒身和笔架，使其对齐。

3. 为什么在准备就绪前不能注射？

如果电池没有正确安装，注射器将无法向前移动。请检查电池是否正确安装。

4. 为什么装入？

在引导螺杆和笔芯的推动活塞间可能存在缝隙。重复进行注射，直到引导螺杆与笔芯完全对齐。

取下针头

取下针头外针套和内针套，并妥善丢弃针套，以备取下针头时使用。

取下针头

取下针头外针套和内针套，并妥善丢弃针套，以备取下针头时使用。

取下针头

取下针头外针套和内针套，并妥善丢弃针套，以备取下针头时使用。

注意：在使用的过程中，如果发现针头有破损，例如断裂、弯曲、漏液、堵塞等，请立即停止使用，并更换新的针头。

1. 为什么在注射时不能向前移动？

只有正确安装电池后，引导螺杆才能向前移动。并

2. 为什么注射器不能向前移动？

检查电池是否正确安装。如果电池安装不正确，注射器将无法向前移动。然后小心地使笔架与笔身成一条直线，旋转注射器筒身和笔架，使其对齐。

3. 为什么在准备就绪前不能注射？

如果电池没有正确安装，注射器将无法向前移动。请检查电池是否正确安装。

4. 为什么装入？

在引导螺杆和笔芯的推动活塞间可能存在缝隙。重复进行注射，直到引导螺杆与笔芯完全对齐。

取下针头

取下针头外针套和内针套，并妥善丢弃针套，以备取下针头时使用。

取下针头

取下针头外针套和内针套，并妥善丢弃针套，以备取下针头时使用。

取下针头

取下针头外针套和内针套，并妥善丢弃针套，以备取下针头时使用。

注意：在使用的过程中，如果发现针头有破损，例如断裂、弯曲、漏液、堵塞等，请立即停止使用，并更换新的针头。